

Solo med Høj Ryg er et løftesejl, som brugeren ikke sidder på. Derfor er den meget let at lægge på og tage af. Solo er designet til at tilpasse sig brugeren uden individuelle indstillinger. Et rigtigt afprøvet og grundigt påsat løftesejl giver brugeren en god tryghedsfølelse og stor komfort.

Solo giver støtte til hele kroppen og en noget tilbage-lænet siddestilling, hvilket passer godt til brugere med nedsat kropsstabilitet. Til større vidde af løftesejlet kan en kombination med Liko Universalbøjle 670 Twin være et godt valg.

Solo anbefales ved løft til eller fra seng, kørestol eller toilet.

Det er vigtigt at vælge den rigtige størrelse for at opnå den største komfort og sikkerhed. Et for stort løftesejl øger risikoen for, at brugeren glider ud, mens et for lille løftesejl bliver snæver i skridtet, hvilket kan give ubehag.


△ Solo med Høj Ryg er et engangsprodukt som er beregnet til én person.

Afprøv korrekt størrelse og skriv brugerens navn på produktetiketten på rygdelen.

Solo med Høj Ryg tages ud af brug:

- når den bliver beskidt eller inficeret
- hvis det bliver beskadiget
- når brugeren ikke længere behøver den.

Kassér sejlet miljørigtigt.

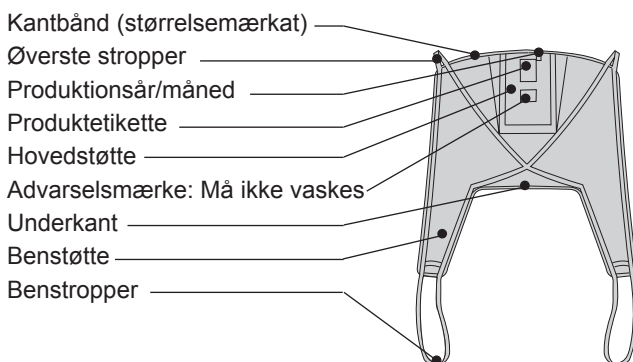

### △ Tænk på!

- Om der er behov for en eller flere medhjælpere, skal bedømmes for hvert tilfælde.
- Planlæg løftet før det udføres, så det sker så trygt og smidigt som muligt.
- Selv om Likos løftebøjler er forsynet med afkrogningsbeskyttelse, skal særlig opmærksomhed iagttages: Før brugeren løftes fra underlaget, men når båndene er strakt er det vigtigt at kontrollere at stropperne sidder korrekt på løftebøjlen!
- Løft aldrig en bruger højere end hvad der er hensigtsmæssigt ift. brugerens forudsætninger. Juster liftens højeste løftehøjde for at umuliggøre en løftesituation hvor brugeren ufrivilligt bliver løftet for højt.
- Ingen spidse eller skarpe genstande må komme i kontakt med produktet.
- Undgå at trække meget i sejlet ved placering af brugeren i kørestol eller seng.
- Kontrollér at brugeren sidder sikkert i sejlet inden forflytningen foretages.
- Efterlad aldrig en bruger uden opsyn i en løftesituation.
- Sørg for at hjulene på kørestol, seng, briks etc. er låste i løftesituationen.

I brugsanvisningen kaldes den som bliver løftet for brugeren, og den som hjælper for medhjælperen.

△ er en advarselstrekant for momenter, hvor særlig forsigtighed bør iagttages.




Læs brugsanvisning på både lift og løftesejl inden anvendelse.

Brugsanvisninger kan downloades gratis på [www.botved.dk](http://www.botved.dk).

## Løft fra siddende stilling


Ifølge de ergonomiske principper anbefales det, at der er to medhjælpere til at lægge løftesejlet på. Normalt er det nødvendigt, at brugeren bøjer sig fremover, når sejlet påføres, og så er det vigtigt, at der står en medhjælper foran brugeren for at forhindre, at denne falder forover.

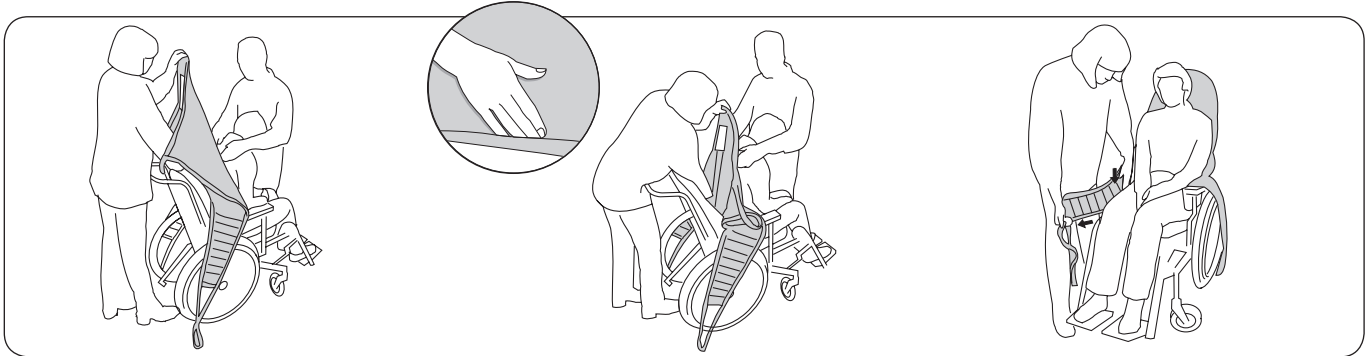

Placer løftesejlet bag brugerens ryg. Produktetiketten placeres udad. Bøj underkanten rundt om fingerspidserne for lettere at styre løftesejlet på plads.

Med håndfladen trykkes løftesejlets underkant ned til brugerens haleben, **det er meget vigtigt**. Det er lettere at lægge sejlet rigtigt på, hvis brugeren bøjer sig lidt fremover.

Træk løftesejlets benstøtte ud og ned langs det yderste af lårene. **Tips!** Med din håndflade mellem kroppen og løftesejlet, fører du benstøttens nedre kantebånd ned til sædet. Træk samtidig benstøtten fremad med den anden hånd for at strække den ud.

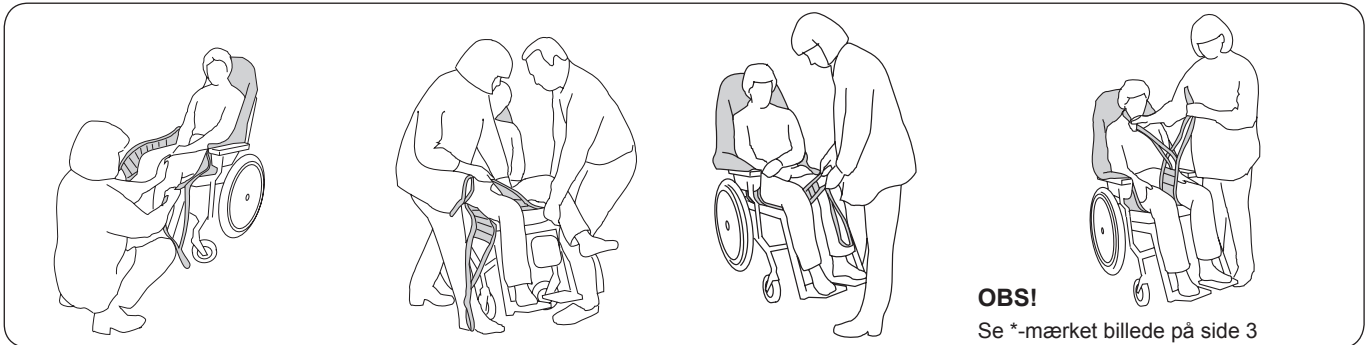

**Tips!** Med et let tryk på brugerens knæ kan man trække benstøtten frem, så eventuelle folder bagtil rettes ud. Kontrollér, at begge benstøtter når lige langt frem.

Før løftesejlets benstøtte ind under hvert lår. Sørg for, at stoffet ligger glat under lårbenet, og at den når ordentligt rundt om benet.


**OBS!**

Se \*-mærket billede på side 3

Benstøtterne samles normalt ved, at den ene benstøtte trækkes igennem den anden, inden de hænges op på løftebøjlen. Hæng de øverste stropper på løftebøjlen og derefter benstroppeperne. Løft.

## Løft fra liggende stilling

Tænk på din egen arbejdsstilling og brugerens komfort. Anvend sengens funktioner til hævnning og sænkning.

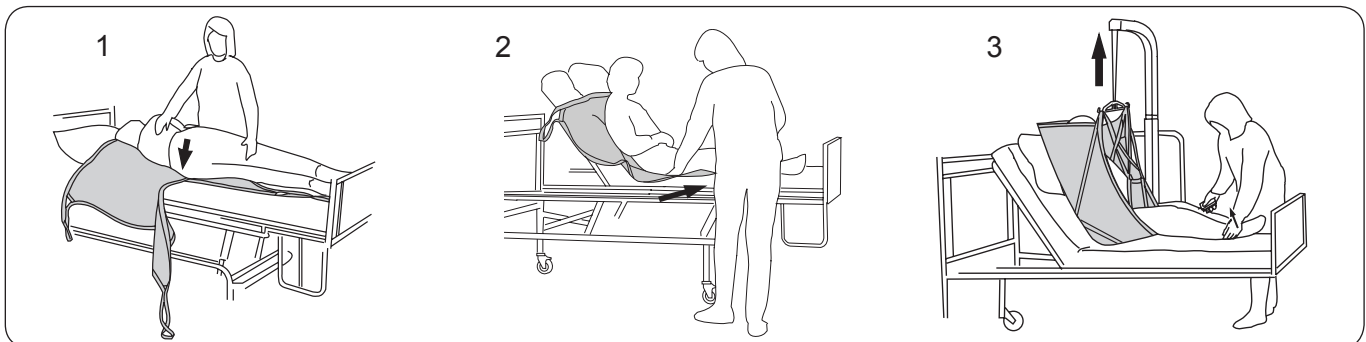

1. Vend brugeren mod dig selv for at undgå, at denne falder ud af sengen. Placér løftesejlet kant så langt ind under brugeren som muligt, om med nederste kant på **niveau med halebenet**. Fold løftesejlet et par gange, så dets midte modsvarer

brugerens rygsøjle når brugeren vendes tilbage. Træk forsigtigt løftesejlet ud på den anden side. Rejs ryggestøtten op.


2. Læg benstøtten på plads under låret. Det gøres nemmest, hvis brugeren bøjer knæene. Sørg for, at stoffet ligger glat, og at det når ordentligt rundt om

benene. Benstøtten kan sættes på forskellige måder.

3. Anbring eventuelt en lille pude bag brugerens hoved. Hæng først de øverste stropper på løftebøjlen og derefter benstroppeperne. Løft.

## Løft til stol/kørestol

Ved placering i kørestol er det vigtigt, at brugeren kommer tilstrækkelig langt tilbage i kørestolen for at sidde godt. Det kan gøres på flere måder.

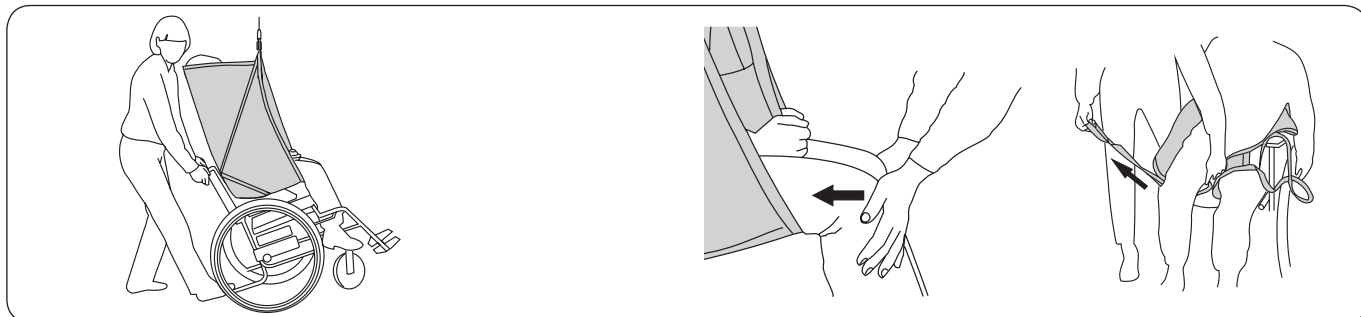


For at gøre placeringen i kørestolen mere smidig, kan man skubbe stolen skråt bagud under sænkningen. Lad bagdelen glide ned langs ryglænet det sidste stykke. Kontrollér kørestolens indstilling med foden på tippeklodsen.

En alternativ metode er at trykke let under brugerens knæ under sænkningen, så bagdelen trykkes ind mod kørestolens ryg. Fjern benstøtterne forsigtigt. Dette gøres bedst ved at trække stropperne ud under den tykke stofdel på sejlets benstøtter. Løsn sejlet ved at trække forsigtigt op.

## Løft til liggende stilling

Tænk over din egen arbejdsstilling og brugerens komfort. Anvend sengens højdeindstilling.

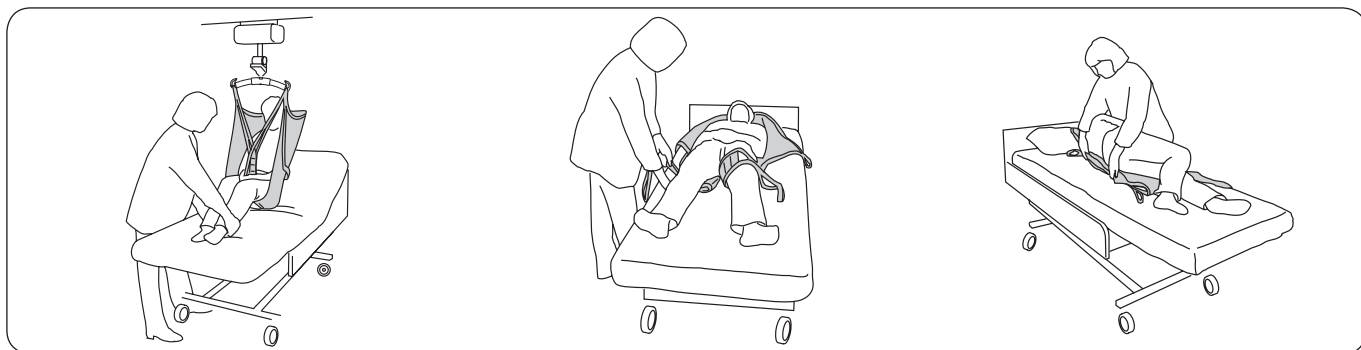


Før brugeren ind over sengen og rejs rygstøtten op for at gøre det mest behageligt for brugeren. Sænk brugeren ned til sengen. Læg rygstøtten ned.

Benstøtten fjernes ved, at man trækker stropperne ud under stofdelen.

Vend brugeren forsigtigt ud til siden og rul løftesejlet ind under denne. Vend brugeren forsigtigt om på ryggen og træk løftesejlen forsigtigt væk.  
*Alternativ:* Fjern løftesejlet ved forsigtigt at trække det opad med brugeren i siddende stilling.

## Brugeren sidder ikke godt - hvad kan det skyldes?

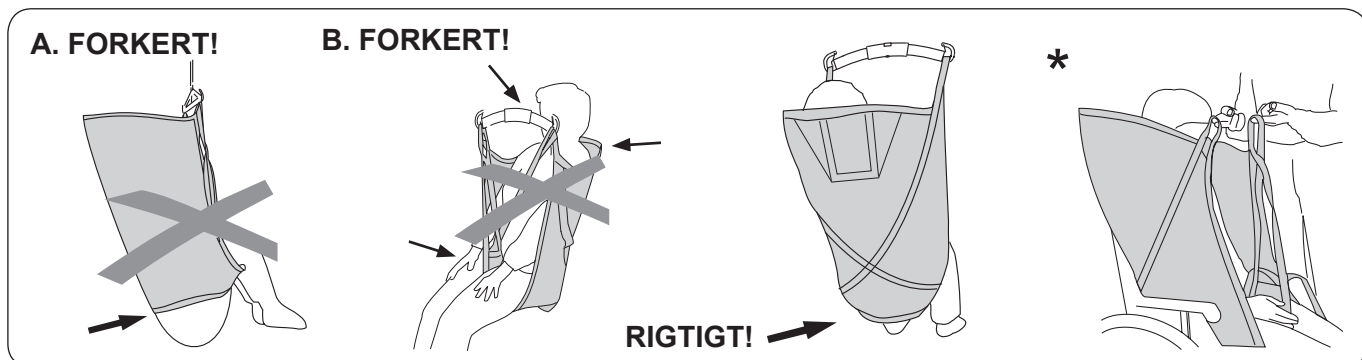


**A. FORKERT!** Bagdelen hænger ned. **Risiko for at glide ud.** Løftesejlet er måske for stort. Det kan også skyldes, at løftesejlet ikke er trukket tilstrækkeligt langt ned i ryggen ved påsætningen. Inden du begynder at løfte, skal du kontrollere, om underkanten er glat, og om stoffet når helt rundt om benene.

**B. En for lille størrelse** kan medføre, at benstøtterne skærer sig ind i skridtet og giver ubehag, at løftebøjlen kommer for tæt på ansigtet, og/eller at ryggen/hovedet får for lav støtte.

Løftesejlets underkant ligger ved halebenet. Benstøtten ligger godt under benene.

**Tips!** Kontrollér, at alle stropper er lige lange, d.v.s. når lige højt, når de strækkes før løft. Hvis ikke, justeres løftesejlets placering.

# Oversigt over Solo med Høj Ryg, mod. 25



Vare	Varenr.	Størrelse	Personvægt*	Maks. belastning
Solo med Høj Ryg	3525911	MS Medium Slim	30-50 kg	200 kg
Solo med Høj Ryg	3525915	M Medium	40-80 kg	200 kg
Solo med Høj Ryg	3525916	L Large	70-120 kg	200 kg
Solo med Høj Ryg	3525917	XL Extra large	110-250 kg	500 kg

\* NB! Den angivne personvægt er kun vejledende - afvigelser kan forekomme.

**For stor størrelse medfører risiko for, at personen glider ud, for lille størrelse kan medføre, at benstøtten skærer ind i skridtet og giver ubehag.**

**Materiale:** Størrelse MS, M og L er fremstillet i ikke vævet Polypropen  
Størrelse XL er fremstillet i ikke vævet Polyester

**Tilbehør:** Stiver, art. nr. 31590007



**MÅ IKKE VASKES.** På løftesejlets bagside findes en etikette med dette symbol. Hvis løftesejlet vaskes forsvinder MÅ IKKE VASKES symbolet og SKAL IKKE ANVENDES symbolet fremkommer. Løftesejlet skal da kasseres.

## Anbefalede kombinationer med Solo med Høj Ryg og Likos løftebøjler:

	Minibøjle 220	Small 350	Universal 350	Standard 450	Universal 450	Universal 600*	Bred 670	Univ. 670 Twin	Firepunktbøjle	Krydsbøjle	Krydsbøjle 450	Krydsbøjle 670	Sidebøjler + Small 350	Univ. Sidebøjler + Universal 350	Standard 450	Univ. Sidebøjler + Universal 450
Solo med Høj Ryg, MS	3	2	2	1	1	2	3	2	1	1	1	2	2	2	2	1
Solo med Høj Ryg, M	3	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1
Solo med Høj Ryg, L	3	3	3	1	1	1	1	1	2	2	1	2	1	1	1	1
Solo med Høj Ryg, XL	4	3	3	2	1	1	1	1	2	2	1	3	2	1	1	1

\* Kun hvis bendelen ligges under begge ben.

**Forklaring:**  
1 Anbefales  
2 Kan fungere  
3 Frarådes  
4 Uegnet

 Medicinteknisk klasse I produkt

Solo med Høj Ryg er testet af akkrediteret testinstitut og overholder alle krav ifølge MDD klasse I produkter, det opfylder også alle krav ifølge standard EN ISO 10535.

Likos produkter udvikles løbende, og vi forbeholder os derfor ret til ændringer i produkter uden forudgående varsel. Kontakt A. P. Botved vedr. information, råd og eventuelle opdateringer.

## **Vigtigt!**

Løft og flytning af en person indebærer altid en vis risiko. Læs derfor brugsanvisningen til både lift og tilbehør grundigt. Det er vigtigt, at du forstår indholdet i brugsanvisningen helt. Kun velinformerede personale bør anvende udstyret. Kontrollér, at løftetilbehøret passer til den lift, der anvendes. Vær forsigtig og omhyggelig ved anvendelsen.

Som medhjælper er du altid ansvarlig for brugerens sikkerhed. Du skal være informeret om dennes muligheder for at håndtere løftesituationen.

Kontrollér løftesejlet før hver løftesituation. Vær især opmærksom på slitage og skader på syninger, materiale, bånd og stropper. Brug ikke beskadiget tilbehør. Kontakt A. P. Botved hvis du er i tvivl om noget.



A  Company

[www.liko.com](http://www.liko.com)

Fabrikant:

**Liko AB**  
SE-975 92 Luleå  
Sweden  
[info@liko.se](mailto:info@liko.se)

