

**RGK**

 **SUNRISE**  
MEDICAL.

# Brugervejledning

**TIGA**FX



DA



Brugervejledning Tiga FX  
UM-TigaFX-023-EU

000691046.DK

**KØRESTOL**  
**BRUGERVEJLEDNING**

# Tak, fordi du har valgt et RGK-produkt.

Velkommen til RGK-serien. Vi håber, at det produkt og den service, du har modtaget, har overgået dine forventninger. Tag dig tid til at læse vejledningen og gøre dig fortrolig med din nye kørestol, så du får det fulde udbytte af kørestolens sikkerhed, ydeevne og lange levetid.

Vi ønsker, at du skal være fuldt ud tilfreds med vores produkter og tjenester, og vi arbejder hele tiden på at videreudvikle vores produkter. Der kan derfor forekomme ændringer i udvalget af produkter, hvad angår udformning, teknologi og udstyr. Som følge heraf kan der ikke rejses erstatningskrav på baggrund af oplysninger eller illustrationer i denne brugervejledning.

## Opsætningsvejledning:

1. Fjern forsigtigt produktet og eventuelle løse dele fra kassen, og sørg for, at der ikke er noget tilbage i emballagen.
2. Læs indholdet af denne brugervejledning grundigt og sørg for, at du forstår sikkerhedsrisiciene.
3. Sæt hjulene og de enkelte dele på.
4. Tjek, at alt er som forventet, og at alle dele er fastgjort, fungerer og er indstillet korrekt, herunder dæktryk.
5. Justér polstringen, så den giver den rette støtte, der passer til din kropsholdning og dine krav til komfort.
6. Justér fodpladens højde, hvis det er nødvendigt, for at sikre korrekt støtte til dine fødder og din balance.
7. Når du er klar og befinder dig i trygge omgivelser, skal du forsigtigt sætte dig i din nye kørestol og sikre, at den fungerer korrekt.
8. Før du kører udendørs eller i ujævnt terræn, skal du sikre dig, at du har testet kørestolen fuldt ud og er fortrolig med tyngdepunktet, og hvordan kørestolen fungerer.
9. Hvis du har spørgsmål til opsætningen af din kørestol, bedes du kontakte din lokale autoriserede forhandler. God fornøjelse!

## BEMÆRK:

Forordning om medicinsk udstyr (EU) 2017/745  
Generelle brugerråd.

Hvis disse anvisninger ikke følges, kan det resultere i personskade, beskadigelse af produktet eller skade på miljøet.

Bemærkning til brugeren og/eller patienten: Alvorlige hændelser, der opstår i relation til enheden, skal indberettes til producenten og den kompetente myndighed i det medlemsland, hvor brugeren og/eller patienten bor.

## ADVARSEL:

Brug ikke dette udstyr før du har læst denne brugervejledning. Hvis du ikke forstår advarslerne og instruktionerne, skal du kontakte RGK eller en sundhedsfaglig person (læge/terapeut), inden du forsøger at bruge dette udstyr – ellers kan det medføre personskade eller beskadigelse af udstyret.

## BEMÆRK:

B4Me særlige indretninger

RGK WHEELCHAIRS anbefaler på det kraftigste, at du læser og forstår alle brugeroplysningerne, der følger med dit B4Me-produkt, inden du bruger produktet for første gang for at sikre, at dit B4Me-produkt fungerer som tiltænkt af producenten.


RGK WHEELCHAIRS anbefaler også, at brugeroplysningerne ikke kasseres efter læsning, men at de opbevares sikkert med henblik på senere brug.

## BEMÆRK:

Kombinationer med medicinsk udstyr

Dette medicinske udstyr kan muligvis kombineres med andet medicinsk udstyr eller et andet produkt. Information om hvilke kombinationer, der er mulige, kan findes på [www.sunrisemedical.dk](http://www.sunrisemedical.dk). Alle de angivne kombinationer er blevet valideret, så de opfylder kravene til generel sikkerhed og ydeevne, Bilag I, punkt 14.1 i Forordning om medicinsk udstyr 2017/745.

SUNRISE MEDICALs kvalitetsstyringssystem er godkendt i henhold til EN ISO 13485. Dette produkt opfylder de standarder, der er angivet i EU- og UKCA-bestemmelser.

 Som producent erklærer SUNRISE MEDICAL hermed, at produktet overholder bestemmelserne i Forordningen om medicinsk udstyr (2017/745).

Sunrise Medical GmbH  
Kahlbaching 2-4  
69254 Malsch/Heidelberg  
Deutschland  
Tel.: +49 (0) 7253/980-0  
Fax: +49 (0) 7253/980-222  
[www.SunriseMedical.de](http://www.SunriseMedical.de)

# Indholdsfortegnelse

4	Manuel kørestol til daglig brug
5	Sikkerhedsoversigt
9	Tjekliste til serviceinspektion
10	Fejlfindingsvejledning, mekanisk
11	Procedure 1 - Polstring
12	Procedure 2 - Drivhjul
13	Procedure 3 - Dæk og slanger
13	Procedure 4 - Camberstang
14	Procedure 5 - Svinghjul og gafler
14	Procedure 6 - Hjullåse
15	Procedure 7 - Fodstøtte
15	Procedure 8 - Skubbehåndtag
16	Procedure 9 - Anti-tipsikringer
17	Procedure 10 - Sidestykker
18	Procedure 11 - Q-Lock sammenklappeligt system
19	Transport
20	Tekniske data
22	Identifikation/serienummer.
23	Producentens garanti

## Forklaringer

### BEMÆRK:

Generelle råd og oplysninger om bedste fremgangsmåde

### ! VIGTIGT:

Gør brugeren opmærksom på mulig risiko for beskadigelse af kørestolen og dens udstyr, hvis det viste råd ikke overholdes.

### ! ADVARSEL:

Gør brugeren opmærksom på mulig risiko for personskade, hvis det viste råd ikke overholdes

### ! RISIKO:

Gør brugeren opmærksom på mulig risiko for alvorlig personskade eller livsfare, hvis det viste råd ikke overholdes

## BEMÆRK:

### BEMÆRK:

Bemærk venligst, at kørsel med kørestol kræver tilstrækkelige kognitive, fysiske og syns-evner. Brugeren skal være i stand til at vurdere følger af handlinger under betjening af kørestolen og, om nødvendigt, korrigere dem. Disse egenskaber og sikker brug af de ekstra monterede komponenter kan ikke vurderes af Sunrise Medical som producent. Vi kan ikke påtage os noget ansvar for eventuelle skader som følge heraf.

Se betjeningsvejledningen til kørestolen og de ekstra monterede komponenter. Instruér brugeren i sikker brug af kørestolen og de ekstra monterede komponenter. Informér brugere om specifikke advarsler, der skal læses, forstås og overholdes.

## BEMÆRK:

De kørestole, der er vist og beskrevet i denne brugervejledning, svarer muligvis ikke nøjagtigt til din egen model. Alle instruktionerne er dog helt relevante, uanset de forskellige detaljer. Producenten forbeholder sig ret til at ændre enhver form for vægtangivelser, mål eller andre tekniske data indeholdt i denne vejledning uden forudgående varsel. Alle tal, mål og kapaciteter vist i denne vejledning er omtrentlige og udgør altså ikke tekniske specifikationer

## BEMÆRK:


Notér venligst din lokale autoriserede forhandlers kontaktoplysninger i det angivne felt. I tilfælde af et funktionssvigt bør du kontakte vedkommende og give denne relevante oplysninger om problemet, så du hurtigst muligt kan få hjælp.



**ISO 7010-M002**  
Brugervejledningen/Dette hæfte skal læses! (Blåt ikon)

# Manuel kørestol til daglig brug

Fig. 1.



**A** - RYGLÆN

**B** - BREMSER

**C** - DRIVHJUL

**D** - SVINGHJUL

**E** - SVINGHJULSGAFFEL

**F** - FODPLADE

**G** - FODPLADEBELÆGNING

**H** - CAMBERAKSEL

**I** - STEL

**J** - AFSTIVER UNDER SÆDE

**K** - PUDE OG BETRÆK

**L** - SIDESTYKKER

# Sikkerhedsoversigt

## Anvendelse

Kørestole er udelukkende beregnet til brug af børn og voksne, der er gangbesværede eller bevægelseshæmmede, til deres personlige brug indendørs eller udendørs, enten som selvkørende, eller når de bliver hjulpet af en tredjepart (skubbet af en ledsager).

Den maksimale vægtgrænse (inkluderer brugeren og vægten på det tilbehør, der er monteret på kørestolen) er angivet på det serienummermærkat, der er fastgjort på camberakslen eller afstiveren under sædet.

Garantien gælder kun, hvis produktet anvendes til de påtænkte formål og under de angivne forudsætninger. Kørestolens forventede levetid er fem år.

Der må IKKE anvendes eller monteres nogen form for tredjepartskomponenter på kørestolen, medmindre sådanne er officielt godkendt af RGK Wheelchairs.

## Anvendelsesområde

De mange forskellige monteringsmuligheder samt kørestolens modulbaserede konstruktion betyder, at denne kørestol er egnet til brugere, som er gangbesværede eller bevægelseshæmmede på grund af:

- Lammelse
- Tab af lemmer (benamputering)
- Deformiteter/misdannelser i benene
- Ledkontraktion/ledskader
- Sygdomme som f.eks. hjerte- eller kredsløbsproblemer, manglende balanceevne eller kakeksi såvel som ældre personer, der stadig har kræfter i overkroppen.

Inden man henviser til en bestemt kørestolsmodel, bør man tage hensyn til brugerens kropsstørrelse og vægt samt personens fysiske og psykiske helbred, alder, boligforhold og omgivelser.

Det endelige valg af den type kørestol, der skal bruges af en person, hviler udelukkende på brugeren og dennes sundhedspersonale, der er i stand til at foretage et sådant valg.

### ADVARSEL:

**KVÆLNINGSFARE** – Dette mobilitetshjælpemiddel bruger små dele, som under visse omstændigheder kan udgøre en kvælningsrisiko for små børn.

## Generel sikkerhed

Kørestolen er udviklet og konstrueret sådan, at den yder maksimal brugersikkerhed. De gældende internationale sikkerhedsstandarder er overholdt, hvor det er relevant. Ikke desto mindre kan brugere komme til skade ved forkert brug af kørestolen. Af sikkerhedsmæssige grunde skal nedenstående regler overholdes.

Uautoriserede eller ukorrekte tilpasninger eller justeringer øger risikoen for ulykker. Som kørestolsbruger er du en del af den daglige trafik på veje og fortove, ligesom alle andre trafikanter. Derfor vil vi gerne minde dig om, at du dermed skal overholde alle gældende færdselsregler.

Vær forsigtig under den første brug af din nye kørestol, og bliv tryk og sikker, før du forsøger dig udendørs eller forsøger at takle vanskelige forhindringer. Huller i vejen eller ujævne overflader kan forårsage, at kørestolen tipper, især ved kørsel op eller ned ad bakker. Læn kroppen forover, når du kører forlæns over et trin eller op ad en skråning.

### ADVARSEL:

Hvis du kører ned ad bakke med høj hastighed i din kørestol, kan det forårsage hjulspind. Det kan føre til ustabilitet og potentielt resultere i personskade.

Følgende bør kontrolleres hver gang, inden kørestolen anvendes:

- Quick-release-aksler på drivhjulene
- Velcro på sæde og ryg
- Dæk og dæktryk
- Bremses

Inden der foretages justeringer af kørestolen, er det vigtigt, at man læser det pågældende afsnit i brugervejledningen.

### RISIKO:

**DU må ALDRIG overskride den maksimale belastning på 110 kg for Tiga FX (85 kg, hvis den anvendes sammen med en håndcykel) for brugeren plus eventuelle genstande, der medbringes på kørestolen. Bemærk, at vægtoplysninger for konfigurationer med lettere enkeltdele er angivet separat. Hvis den maksimale belastning overskrides, kan dette medføre skader på kørestolen samt risiko for, at du falder ud, at kørestolen vælter, eller at du mister kontrollen, hvorved du selv og andre kan udsættes for alvorlige personskader.**

# Sikkerhedsoversigt Fortsat

- Ved transport i et køretøj udstyret specielt til handicapbrug skal passagererne for så vidt muligt altid bruge de fastmonterede sæder og forsvarlige sikkerhedsseler i køretøjet. Det er kun ved at følge denne metode, at man kan sikre passagerernes bedst mulige beskyttelse i tilfælde af biluheld.
- For at undgå, at kørestolen vælter, eller at der opstår andre farlige situationer, bør du altid øve dig i brugen af den nye kørestol på en jævn kørselsflade med godt udsyn.
- Denne kørestol må kun bruges af én person ad gangen. Enhver anden form for anvendelse er ikke i overensstemmelse med det tilsigtede formål.
- Brug ikke fodpladerne, når du stiger på eller af kørestolen. Fodpladerne bør slås op og svinges så langt ud til siden som muligt, inden du stiger ud eller ind. (hvor det er relevant)
- Afhængigt af svinghjulenes diameter og indstilling samt kørestolens tyngdepunkt kan det forekomme, at svinghjulene begynder at slingre ved høje hastigheder. Dermed er der risiko for, at svinghjulene blokeres, og at kørestolen tipper forover.
- Det er desuden særligt vigtigt, at man ikke kører på skråninger, hvis bremsene ikke er aktiveret. Kør med nedsat hastighed. Sidelæns kørsel på en hældning eller skrånning kan forøge risikoen for, at kørestolen tipper sidelæns.
- Sørg for at afprøve, hvad der sker, når ændringer af tyngdepunktet påvirker kørestolens balance, f.eks. op og ned ad skråninger eller ved kørsel over forhindringer. Dette bør altid udføres med hjælp fra en erfaren ledsager.
- Det anbefales desuden, at uerfarne brugere anvender tipsikringer.

## Vægttræning

RGK anbefaler IKKE at bruge sin kørestol som vægttræningsudstyr. Dette produkt er IKKE designet eller testet som et sæde til nogen form for vægttræning. Hvis brugeren anvender kørestolen som vægttræningsudstyr, er RGK IKKE ansvarlig for personskade eller skade på udstyret, og garantien bortfalder øjeblikkeligt.

### **! ADVARSEL:**

Produkter, der efterlades i ekstremt varme eller kolde omgivelser, kan resultere i varme/kolde overflader, som kan medføre personskade.

Udsæt ikke produktet eller noget af dets tilbehør for nogen form for kraftig varme eller åben ild, herunder cigaretter.

Dette produkt har bevægelige dele og kan derfor klemme brugerens fingre. Vær yderst forsigtig, når du bevæger stolen.

## Stabilitet og balance

For at sikre stabilitet og korrekt betjening af din kørestol skal du hele tiden holde balancen. Din kørestol er designet til at forblive oprejst og stabil under normale daglige aktiviteter, så længe du ikke bevæger dig ud over tyngdepunktet. Alle aktiviteter, der involverer bevægelse i stolen, har en indvirkning på tyngdepunktet.

Sørg for, at svinghjulene peger bagud, når du læner dig forover. Det kan man gøre ved at køre stolen frem og derefter bakke den i en lige linje. Se Fig. 2.

Fig. 2.



### **! ADVARSEL:**

Fodstøttens placering, camberrøret, højden og stramningen af ryglænets polstring har en direkte indvirkning på stolens stabilitet. Enhver ændring af en eller en kombination af de tre kan medføre, at kørestolen bliver mindre stabil. Vær EKSTREMT forsigtig, når du bruger en ny siddestilling for første gang.

### **! ADVARSEL:**

**Dæktryk**  
Brug IKKE din kørestol, medmindre den har det korrekte dæktryk (P.S.I.).

Dækkene må IKKE pumpes for meget op. Hvis du ikke følger disse råd, kan dækket eksplodere og forårsage personskade.

# Sikkerhedsoversigt Fortsat

- Tipsikringer monteres for at forhindre, at kørestolen utilsigtet tipper bagover. De bør under ingen omstændigheder anvendes i stedet for transihjul eller ved transport af en passager i en kørestol, hvor drivhjulene er afmonteret.
- I forbindelse med indstillinger i yderposition (f.eks. hvis drivhjulene sidder så langt fremme som muligt), hvor brugeren ikke har den rette kropsholdning, risikerer man, at kørestolen vælter selv på jævne kørselsflader.
- Der må ikke hænges tunge varer, som for eksempel indkøbsposer eller rygsække på kørestolens skubbehåndtag, nakkestøtte eller ryglæn. Dette kan ændre balancepunktet, og der er risiko for at kørestolen tipper bagover.
- Når du vækkes ud efter noget hvad enten det befinder sig foran, ved siden af eller bag ved kørestolen, skal du altid sørge for, at du ikke læner dig for langt ud af kørestolen. Hvis du gør det, kan det ændre tyngdepunktet, og så er der risiko for, at den tipper eller vælter.
- Sørg altid for at anvende kørestolen på forsvarlig vis. F.eks. bør du altid undgå at køre ind mod eller over forhindringer (såsom trin og kantsten) uden at bremse imens, og du bør ikke køre hjulene hårdt ned i fordybninger eller anvende rulletrapper.
- Kørsel på trapper bør kun ske med hjælp fra en ledsager. Der findes særligt udstyr til hjælp med f.eks. kørsel på ramper eller af og på kørestolslifte, som bør anvendes. Hvis der ikke er egnet udstyr til rådighed, skal kørestolen tippes bagover og skubbes hen over forhindringen (dette kræver 2 ledsagere).
- Normalt bør enhver form for antitipstøtter, som er monteret på kørestolen, indstilles forud for forcering af trin o.l., så støtterne ikke kan komme i kontakt med forhindringen. I modsat fald risikerer man at komme alvorligt til skade, hvis kørestolen vælter. Efter forceringen skal tipsikringerne indstilles, så de sidder i den rette position igen.
- Sørg for, at ledsageren kun holder i kørestolen ved hjælp af de dele, der sidder forsvarligt fast (dvs. ikke fodstøtterne eller sidestykkerne).
- Når man anvender kørestolslift, skal man sørge for, at eventuelle påmonterede tipsikringer er placeret, så de ikke rager ud over platformen.
- Fastgør din kørestol er på en ujævn overflade, eller ved overførsel til og fra kørestolen (f.eks. ind og ud af en bil) ved brug af bremsehåndtagene.
- Hjullåsene fungerer kun, hvis der er tilstrækkelig højt dæktryk, og indstillingerne er udført korrekt (se kapitlet "Hjullåse").
- Når du færdes i mørke, bør du altid være iført lyst tøj eller tøj med reflekser, så du bedre kan ses. Sørg for, at reflekserne i hver side og bag på kørestolen er fuldt synlige. Det anbefales også, at du monterer en egentlig lygte på kørestolen.
- Justeringer af kørestolen, især justeringer af sikkerhedsrelaterede komponenter, for eksempel bremses, tipsikringer og ryglæn skal foretages af en autoriseret forhandler.
- Det anbefales at rengøre og desinficere hele produktet ofte, især betrækket.
- Vip ikke kørestolen uden hjælp
- Genbrug ikke fastspændingsanordningerne til engangsbrug
- Bremserne er ikke beregnet til at bremse en kørestol i bevægelse. De er kun monteret for at sikre, at kørestolen ikke pludselig begynder at køre af sig selv. Når du stopper på en ujævn overflade, bør du altid bremse kørestolen for at undgå, at den kører af sig selv. Slå altid begge bremses til, da kørestolen ellers kan tippe.
- Bremserne er ikke beregnet til at bremse en kørestol i bevægelse.
- Gør altid brug af elevatorer og ramper. Hvis de ikke findes på steder, hvor det er relevant, bør du bede en ledsager om hjælp. Kørestolen må kun løftes i de dele, der er forsvarligt monteret. Hvis der er monteret tipsikringer skal disse fjernes/drejes væk inden løftet Kørestolen må kun skubbes og aldrig løftes, hvis der sidder en person i den.
- Hvis sædet og rygpølstringen er beskadiget, skal de udskiftes med det samme.
- Du må ikke løfte eller bære kørestolen ved hjælp af rygrørene eller skubbehåndtagene.
- Vær ekstra forsigtig i nærheden af åben ild, især glødende cigaretter. Sædet og rygpølstringen er fremstillet af materialer, som let kan antændes.

## Indikationer:

De mange forskellige monteringsmuligheder samt kørestolens modulbaserede konstruktion betyder, at denne kørestol er egnet til brugere, som er gangbesværede eller bevægelseshæmmede på grund af:

- Lammelse
- Tab af lemmer (benamputering)
- Deformiteter/misdannelser i benene
- Ledkontraktion/ledskader
- Sygdomme som f.eks. hjerte- eller kredsløbsproblemer, manglende balanceevne eller kakeksi, muskeldystrofi, hemiplegi. Desuden er kørestolen egnet til ældre personer, som stadig har kræfter i overkroppen.

## Kontraindikationer:

Kørestolen må ikke anvendes uden ledsager i tilfælde af:

- Perceptionsforstyrrelse
- Ubalance
- At begge arme mangler, hvis vedkommende ikke understøttes af en omsorgsperson
- Ledkontraktur eller ledskade på begge arme
- Nedsat siddefunktion

# Sikkerhedsoversigt Fortsat

- Sørg altid for, at quick-release-akslerne på drivhjulene er indstillet korrekt og er låst på plads. Hvis knappen på quick-release-akslen ikke er trykket ind, kan drivhjulet ikke tages af.
- Især ved brug af drivringe i letvægtsmetal er der risiko for, at man brænder fingrene ved hårde opbremsninger, eller når der bremses på lange skråninger.
- Hvis kørestolen udsættes for direkte sollys i lang tid, kan dele af kørestolen (f.eks. stel, benstøtter, bremses og sidestykke) blive varme (>41 °C).
- For at undgå skader på hænderne bør man lade være med at gribe mellem egerne eller mellem drivhjulet og bremsen, mens kørestolen er i bevægelse.
- Kørestolen må ikke anvendes på skråninger > 5°.
- Den maksimale hældningsgrad for sikker kørsel på skråninger er dynamisk, dvs. den afhænger af kørestolskonfigurationen, brugerens fysiske evner samt den måde, brugeren kører på. Eftersom brugerens fysiske evner og måde at køre på er forskellige fra person til person, kan den maksimale hældningsgrad for sikker kørsel ikke angives her. Denne hældningsgrad skal derfor fastslås af brugeren selv med hjælp fra en ledsager for at undgå, at kørestolen tipper på skråninger. Det anbefales på det kraftigste, at uerfarne brugere får monteret anti-tip sikringer på kørestolen.
- Kørestolen må ikke anvendes på mudrede eller isglatte kørselsflader.
- Kørestolen må ikke anvendes på steder, hvor der ikke er adgang for fodgængere.
- Kørestolen bør anvendes med forsigtig i kraftig regn, sne eller glat føre, eller hvor kørselsfladen er i uforvarlig stand.
- Kørestolen må ikke anvendes i farlige omgivelser.

# Tjekliste til serviceinspektion

## BEMÆRK:

Regelmæssig rengøring vil hjælpe med at afsløre eventuelle løse eller slidte dele og forbedre kørestolens funktion. For at fungere korrekt og sikkert skal din kørestol vedligeholdes ligesom ethvert andet køretøj. Rutinemæssig vedligeholdelse forlænger din kørestols levetid og effektivitet. De første justeringer bør foretages, så de passer til din personlige kropsbygning og dine præferencer. Hvis kørestolen skal opbevares i en længere periode, er det ikke nødvendigt at gøre yderligere. Sørg for, at kørestolen opbevares ved stuetemperatur et tørt sted, der er beskyttet mod stærkt sollys. Før kørestolen tages i brug igen, skal den kontrolleres af en godkendt forhandler. Derefter skal du følge de vedligeholdelsesprocedurer, der er beskrevet nedenfor:

Enhed	Indledningsvis	Inspicér/ Justér Ugentligt	Inspicér/ Justér Månedligt	Inspicér/ Justér Årligt
<b>Generelt</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kørestolen kører lige (ingen overdreven modstand eller træk til den ene side)</li> <li>Inspicér stellet for revner og skader</li> <li>Inspicér, at alle fastgørelseselementer er sikret</li> </ul>	✓		✓	✓
<b>Bremser</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Må ikke have kontakt med dækkene, når de kører rundt</li> <li>Drejepunkter skal være fri for slitage og løshed</li> <li>Hjullåsene skal være nemme at aktivere</li> </ul>	✓ ✓ ✓		✓ ✓ ✓	
<b>Sæde- og ryglænsbetræk</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Inspicér for revner eller løshed</li> <li>Inspicér fastgørelsesflapperne for at sikre, at de sidder godt fast</li> </ul>	✓ ✓		✓	✓
<b>Drivhjul (baghjul)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Justerbar camberstang til akselposition er forsvarligt fastspændt</li> <li>Quick-/quad release-aksler låses korrekt</li> <li>Ingen overdreven sidebevægelse eller binding, når de løftes og drejes rundt</li> </ul>	✓ ✓ ✓	✓ ✓	✓	
<b>Drivring</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Se efter tegn på ru kanter eller afskalning</li> </ul>	✓	✓		
<b>Eger</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Se efter bøjede eller knækkede eger</li> <li>Alle eger er ensartet stramme</li> </ul>	✓ ✓		✓ ✓	
<b>Forreste svinghjul</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kontrollér, at hjul/gaffelsamlingen er spændt korrekt ved at dreje svinghjulet rundt; svinghjulet skal stoppe gradvist</li> <li>Løsn/stram låsemøtrikken, hvis hjulet slinger mærkbart eller går i stå</li> <li>Hjullejerne er rene og fri for fugt</li> </ul> <p>VIGTIGT: Som med alle andre køretøjer bør hjul og dæk kontrolleres regelmæssigt for revner og slitage og udskiftes, når det er nødvendigt</p>	✓ ✓ ✓		✓ ✓ ✓	✓
<b>Dæk</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Se efter flade områder og slid</li> <li>Hvis dækkene er pneumatiske, skal du kontrollere, at de er korrekt pumpet</li> </ul> <p>VIGTIGT: Som med alle andre køretøjer bør hjul og dæk kontrolleres regelmæssigt for revner og slitage og udskiftes, når det er nødvendigt</p>	✓ ✓	✓ ✓		
<b>Rengøring</b>	✓		✓	

# Fejlfindingsvejledning, mekanisk


Kørestolen drejer mod højre	Kørestolen drejer mod venstre	Langsom drejning eller ydeevne	Vibrationer fra svinghjul	Knirken og raslen	Løshed i kørestolen	Løsninger
✓	✓	✓	✓			Tjek dækkene for korrekt og ensartet dæktryk
		✓	✓	✓	✓	Tjek for løse møtrikker i svinghjul Tjek, at alle løsdele sidder sikkert og forsvarligt
				✓	✓	Tjek egernes spænding
✓	✓		✓			Tjek, at begge svinghjul rører jorden på samme tid

## ADVARSEL:

Efter justering skal du altid sikre dig, at delene er spændt ordentligt, FØR du bruger kørestolen. Spænd IKKE beslag, der er fastgjort til stellet, for meget. Det kan medføre skader på kørestolen.

# Procedure 1 - Polstring

Polstringen er fuldt justerbar og kan let justeres, så den giver den rette balance og komfort i din nye kørestol.



## 1.1: Justering af sæde

Fjern puden fra kørestolen. Sædet justeres ved at øge eller mindske spændingen i stropperne på undersiden af sædet (fig. 4). For at fjerne det skal du løsne alle stropper og tage det af.



## 1.2: Justering af ryglæn

Fjern puden og midterpuden fra kørestolen (fig. 3). Ryglænet justeres ved at øge eller mindske spændingen i stropperne bag på ryglænet. For at fjerne det skal du løsne alle stropper og tage det af.

## 1.3: Skift af pudebetræk

Fjern puden fra kørestolen. Åbn velcrolommen bag på puden, og fjern eller udskift skumindlægget efter behov. (Fig. 5).



## ⚠ ADVARSEL:

Fodstøttens placering, camberrøret og sædehøjden bagtil samt stramningen af ryglænets polstring har en direkte indvirkning på stolens stabilitet. Enhver ændring af en eller en kombination af de fire dele kan medføre, at kørestolen bliver mindre stabil. Vær EKSTREMT forsigtig, når du bruger en ny siddestilling for første gang.

## ⚠ VIGTIGT:

Velcro på polstring kan forårsage materielle skader ved nærkontakt.

# Procedure 2 - Drivhjul

Drivhjulene (baghjulene) er af typen "quick release" og er designet til at blive taget af og sat på ofte. Alle drivhjul (baghjul) bruger quick release-akselstappe til at fastgøre hjulene til stellet, og selv om de varierer i længden, fungerer de på samme måde.

## 2.1: Afmontering/påmontering af drivhjul

Tryk på quick release-knappen, og træk hjulet udad. Ved påmontering skal du trykke på knappen, holde den inde og sætte quick-release-akselstappen ind i akslen, indtil tappen klikker på plads. Sørg for, at begge hjul er helt i indgreb før brug.



Fig. 6.

### **! ADVARSEL:**

Hvis du ændrer størrelsen på dine drivhjul (baghjul), kan det have stor betydning for kørestolens ydeevne og stabilitet.

## 2.2: Justering af quick release-akselstappen

Justér kun quick release-akselstappen, hvis hjulet ikke går i indgreb, eller hvis hjulene føles løse. For at justere længden fjernes akselstappen fra hjulet, og ved hjælp af 2 x justerbare skrueøglere som vist på fig. 7 forlænges eller forkortes tappen efter behov.




Fig. 7.

A = Forlæng      B = Forkort

### **! ADVARSEL:**

Hvis du justerer dine quick release-tapper - så skal du sikre, at hjulene låses på begge sider af kørestolen. Når du monterer drivhjulene (baghjulene), skal du altid kontrollere, at de sidder godt fast. Træk i drivhjulene (baghjulene) for at sikre, at låsepinden/RGK-hætten på quick release-akselen er helt frigjort, før kørestolen betjenes.

Du bør IKKE kunne trække drivhjulet (baghjulet) af.

# Procedure 3 - Dæk og slanger

Dæk slides ligesom et bildæk, og tiden afhænger af brugen. Det anbefales, at begge dæk skiftes, når slidbanen forsvinder. For pneumatiske dæk (luftdæk) er der en risiko for, at der opstår en punktering, og at slangen skal udskiftes for at holde kørestolen funktionsdygtig.

## 3.1: Skift af dæk

Fjern hjulet fra kørestolen, og slip luften ud af slangen ved at trykke på den lille stift inde i ventilen, hvis det er en Presta-ventil. Skru derefter både hovedet og sikringsringen i bunden af, og tryk den så ned, indtil luften slipper ud. Brug 2 x dækjern (medfølger i værktøjssættet) til at hægte dækket helt af fælgen. Fjern slange og dæk fra fælgen.

Når du skal montere dækket, skal du placere den ene side af det nye dæk på fælgen. Sæt derefter slangen ind i dækket, og ret ventilen ind efter fælgens hul. Sørg for, at der ikke er nogen knæk eller ujævn spænding i slangen, før

du sætter den anden side af dækket tilbage på fælgen ved hjælp af dækjernene. Pas på ikke at klemme slangen. Når dæk og slange sidder på fælgen, skal du sætte en eventuel sikringsring (hvis relevant) på og pumpe dækket lidt op. Justér slange og dæk, så de sidder godt på fælgen, og pump dækket op til det anbefalede dæktryk.

## 3.2: Udskiftning af slangen

Gentag metoden ovenfor, men fjern ikke dækket helt, men kun slangen. Hvis problemerne fortsætter, skal du fjerne dæk og slange og sikre, at der ikke er skarpe kanter i fælgen, som kan forårsage en punktering.

# Procedure 4 - Camberstang

Camberakslen eller camberrøret styrer hjulets position og tyngdepunktet. Det er meget vigtigt, at den er indstillet til dine krav til ydeevne og sikkerhed. Akselrøret kan være fast eller justerbart. Fast betyder, at det ikke kan justeres, og at det er beregnet til en erfaren bruger, der kender sit tyngdepunkt. Justerbar position giver brugeren valgmuligheder og er ideel til mindre erfarne brugere.

## 4.1: Justering af akselrørets position

Fjern hjulene for at justere akselpositionen. Brug en 5 mm unbrakonøgle fra værktøjssættet til at løsne den øverste skrue på hver side af akselklemmen som vist på fig. 8 (A). Når skruen er løsnet, men stadig intakt, skal du flytte akslen bagud for at få større stabilitet og fremad for at få at opnå en større vippevinkel. Stram de øverste skruer, når positionen er indstillet, og brug stolen forsigtigt, som da du brugte den første gang.

## 4.2: Udskiftning af akselrør

Fjern hjulene for at udskifte akselrøret. Brug en 5 mm unbrakonøgle fra værktøjssættet til at løsne den nederste skrue helt på hver side af akselklemmen som vist på fig. 8 (B). Læg mærke til afstanden mellem akselklemmen og akselrøret, så du kan indstille det nye akselrør. Skub det nye rør ind i klemmerne og i samme position som det gamle akselrør. Hakket i akselindsatsen skal være øverst på akselrøret.

Hvis kørestolen føles langsom efter udskiftning af akselrøret, skal du dreje akselrøret lidt frem eller tilbage for at korrigere hjulindstillingen.

## ADVARSEL:

Fodstøttens placering, camberstangen samt stramningen af ryglænets polstring har en direkte indvirkning på stolens stabilitet.

Enhver ændring af en eller en kombination af de tre kan medføre, at kørestolen bliver mindre stabil. Vær EKSTREMT forsigtig, når du bruger en ny siddestilling for første gang.



A = Justér position  
B = Fjern og udskift

## Procedure 5 - Svinghjul og gafler

Svinghjulene foran på kørestolen slides ligesom bildæk og bør udskiftes, når de ser synligt slidte ud, eller når der opstår revner.

### 5.1: Skift af svinghjul

Brug 2 x 4 mm unbrakonøgler fra værktøjssættet til at fjerne 1 af de 2 skrue i midten af hjulet, som vist på fig. 9. Fjern skruen, og skub hjulakslen ud med den anden skrue stadig fastgjort, og bemærk eventuelle afstandsstykker og deres placering. Monter det nye svinghjul, og skub hjulakslen tilbage, og fastgør den med den sidste skrue.

Fig. 9.



### 5.1: Sådan tages svinghulets hjulgaffel af

Fjern dækslet oven på hjulhuset. Brug indstiksnøglen fra værktøjssættet til at løsne og fjerne låsemøtrikken. Dette frigør hjulgaflen. Bemærk eventuelle afstandsstykker og deres placering.

### BEMÆRK:

Svinghjulets lejer skal monteres af en autoriseret forhandler. Hvis det ikke sker, bortfalder garantien på delene.

### ! VIGTIGT:

Udskift IKKE de forreste hjulgafler eller svinghjul med en anden størrelse end den, der oprindeligt sad på kørestolen.

Hvis man skifter til en anden størrelse hjulgaffel eller svinghjul, vil det have en negativ indvirkning på stolens funktion og slutbrugerens balance, hvilket kan føre til personskade.

## Procedure 6 - Hjullåse

Hjullåsene kan justeres i position, så de passer til dækskift og slid. Når dækkene slides, holder hjullåsene måske ikke kørestolen som tiltænkt, så de skal justeres, så de passer til dækkenes tilstand.

### BEMÆRK:

Før du justerer eller udskifter en hjullås, skal du sikre dig, at dækkene er pumpet op til det anbefalede dæktryk, som er angivet på dækket.

Fig. 10.



Fig. 11.



### 6.1: Justering af hjullåse

Brug en 5 mm unbrakonøgle fra værktøjssættet til at løsne de 2 skrue i klemmen eller på undersiden af pladen. Når hjullåsen er løsnet, skal den flyttes, så der er mindst 3 mm mellemrum, når hjullåsen aktiveres. Stram godt til, og gentag på den anden side.

### ! ADVARSEL:

Efter enhver justering, reparation eller service og før brug skal du sørge for, at alle fastgørelseselementer er spændt ordentligt – ellers kan der opstå skader. Hvis hjullåsene ikke holder kørestolen med bruger på plads, skal du justere dem som beskrevet ovenfor eller kontakte din forhandler – ellers kan der opstå skader. Hjullåsene er designet til at fungere, når din kørestol er statisk. Hjullåse må ikke anvendes under brug, og dæktrykket skal være som angivet på dækket.

# Procedure 7 - Fodstøtte

Det kan være nødvendigt at justere fodstøtten, når du bruger kørestolen første gang, hvis omstændighederne ændrer sig, eller hvis fastgørelseselementerne løsner sig. Det er vigtigt at kontrollere højden med jævne mellemrum og justere efter behov.

## 7.1: Justér fodstøttens højde

Før justering skal du notere den aktuelle eller ønskede højde og markere efter behov. Brug en 4 eller 5 mm unbrakonøgle fra værktøjssættet til at løsne de 2 skruer i klemmerne på fodstøtten. Sæt fodstøtten tilbage i den rigtige højde, og spænd skruerne godt fast.


## 7.2: Justering af fodstøttens vinkel

Med en fodstøtte med justerbar vinkel løsnes de 2 klemmeskruer i midten af fodpladen ved hjælp af en 4 mm unbrakonøgle og en 10 mm nøgle fra værktøjssættet. Sæt fodstøtten tilbage i den rigtige vinkel, og spænd skruerne godt fast.

### **ADVARSEL:**

Fodstøtten SKAL være mindst 40 mm over jorden/gulvet for at undgå at ramme fremspringende genstande, når man bruger denne kørestol.

Fig. 12.



# Procedure 8 - Skubbehåndtag

Der kan leveres en række skubbehåndtag til denne kørestol, som kan bruges af en ledsager og betjenes i henhold til følgende procedurer.

## 8.1: Justering af højdejusterbare skubbehåndtag

Slip midterhåndtaget, og anbring det i den ønskede højde, og stram derefter håndtaget for at sikre det. Gentag på den anden side for at få en ensartet højde mellem begge håndtag.

Fig. 13.



Højdejusterbare skubbehåndtag

### **ADVARSEL:**

Forsøg IKKE at løfte kørestolen ved hjælp af aftagelige dele, f.eks. højdejusterbare skubbehåndtag, flip-down skubbehåndtag og fastskruede skubbehåndtag

## 8.2: Fastskruede skubbehåndtag

Fastskruede skubbehåndtag kan afmonteres ved at skru dem ud af ryglænet. Skru dem fast med hånden, indtil de sidder fast.

Fig. 14.




Fastskruede skubbehåndtag

## 8.3: Betjening af flip-down skubbehåndtag

Tryk på knappen under håndtaget, og skub håndtaget ned samtidig. Gentag på den anden side. Træk håndtaget op, indtil det klikker på plads, så det vender tilbage til udgangspositionen.

Fig. 15.

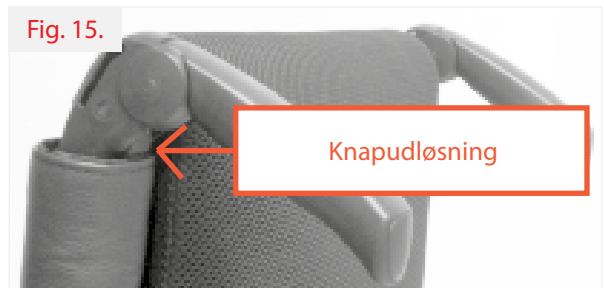

Flip-down skubbehåndtag

# Procedure 9 - Anti-tipsikringer

En anti-tipsikring kan bruges til at gøre stolen mere stabil og anbefales af den sundhedsfaglige profession.

## 9.1: Sving-away anti-tipsikring

Hvis du vil opbevare anti-tipsikringen, skal du trykke ned på det fjederbelastede rør, indtil det løsner sig fra huset. Sving den 180 grader under stolen og ind i låst position. Hvis du vil vende tilbage til betjeningspositionen, gentages proceduren på samme måde. Hvis du vil justere længden, skal du trykke på knappen på røret og forlænge eller forkorte hjulrøret.

## 9.2: Enkelt anti-tipsikring til sportsaktiviteter

Hvis du vil fjerne anti-tipsikringen, skal du fjerne quick release-tappen og fjerne røret. Klemmen, der er fastgjort til stellet, er monteret fra fabrikken og kan kun fjernes af en godkendt kørestolstekniker.

### **ADVARSEL:**

RGK anbefaler på det kraftigste at bestille anti-tipsikring som en ekstra sikkerhed for kørestolsbrugeren.

### **ADVARSEL:**

Anti-tipsikringerne SKAL være fuldt aktiveret. Sørg for, at anti-tipsikringens udløserknop stikker helt ud af hullet i anti-tipsikringens sokkel.

Sørg for, at begge anti-tipsikringer er justeret til samme højde.

Fig. 16.



Fig. 17.



Fig. 18.



# Procedure 10 - Sidestykker

Sidestykker støtter brugeren og forhindrer, at tøjet bliver snavset. Selv om disse kun kræver lidt vedligeholdelse, er udskiftning vist nedenfor.

## 10.1: Skru sidestykkerne fast

Fjern drivhjulene (baghjulene). Brug en 4 mm unbrakonøgle fra værktøjssættet til at løsne de 3 skruer i sidestykkerne. Montér alle skruer, men spænd ikke, før alle er på plads. Pas på ikke at ødelægge gevindet på skruerne.



## 10.3: Fold sidestykkerne helt ned

Brug en 3 mm unbrakonøgle fra værktøjssættet til at fjerne de 4 skruer indeni sidestøtten. Montér alle skruer, men spænd ikke, før alle er på plads. Pas på ikke at ødelægge gevindet på skruerne.




## 10.2: Tag sidestykkerne af

Fjern sidestykkerne fra holderne. Brug en 4 mm unbrakonøgle fra værktøjssættet til at løsne de 2 skruer i sidestykkerne, så de kan løftes op. Sæt de 2 skruer på plads, og spænd dem. Pas på ikke at ødelægge gevindet på skruerne.



## 10.4: Klap sidestykkerne tilbage

Brug en 4 mm unbrakonøgle fra værktøjssættet til at løsne de skruer i sidestykkerne, så de kan løftes op. Sæt de 2 skruer på plads, og spænd dem. Pas på ikke at ødelægge gevindet på skruerne.



# Procedure 11 - Q-Lock sammenklappeligt system

## **ADVARSEL:**

Dit sammenklappelige ryglæn og sammenklappelige forramme SKAL være låst forsvarligt på plads, før du bruger din kørestol.

### 11.1: Sådan klapper du ryglænet ned med Q-Lock-systemet

Drej drejelåsen hen på åben position, fig. 23. Tryk på udløserknappen og skub ryglænet ned. Du aktiverer igen ved at trække ryglænet op, indtil udløserknappen går i indgreb, og drej derefter drejelåsen hen på låst position fig. 24.

Fig. 23.



Fig. 24.



### 11.2: Sådan klapper du frontrammen sammen med Q-Lock-systemet

Fjern drivhjulene, og drej låskraverne hen på åben position. Tryk derefter begge Q-låsehåndtag ned, så den sammenklappelige forramme kan foldes ind under stolen. Hvis fodstøtten skal flyttes, skal du blot trække den forreste del fremad, så Q-låsehåndtagene klikker på plads. Når Q-låsehåndtagene er klikket på plads, skal du dreje drejelåskraverne hen på låst position.

### 11.3: Justering af Q-Lock

Bag Q-Lock sidder en fingerskrue, som kan bruges til at stramme eller løsne Q-Lock-samlingen. Brug en 3 mm unbrakonøgle fra værktøjssættet til at justere med. Justér kun, hvis forrammen føles løs, eller hvis låsen ikke går i indgreb.

## **VIGTIGT:**

Dette produkt indeholder bevægelige dele. Pas på, at du ikke får fingrene i klemme.

## **ADVARSEL:**

Drejelåsene skal være i låst position, når de er i brug. Hvis det ikke er tilfældet, kan du deaktivere udløserknapperne og forhindre stellet i at lukke sig, hvilket kan forårsage alvorlig personskade og skade på udstyret.

## **ADVARSEL:**

Kontrollér altid, at Q-Lock-samlingen sidder forsvarligt på plads, og at alle skrue er spændt. Der må ikke være for meget slør i Q-Lock-samlingen under brug. Foretag eventuelle nødvendige justeringer før brug.

# Transport

**RISIKO:**

Hvis dette påbud ikke overholdes, er der risiko for alvorlige personskader eller livsfare.

## Transport af kørestolen i et køretøj

En kørestol, der er fastspændt i et køretøj, giver ikke samme sikkerhed og beskyttelse under transporten, som hvis man bruger køretøjets faste sæder og sikkerhedsseler. Vi anbefaler, at brugeren flyttes over i køretøjets faste sæder. Det er anerkendt, at det ikke altid er praktisk for brugeren at blive forflyttet, og under disse omstændigheder anbefaler RGK brugen af en kollisionstestet kørestol.

# Tekniske data

Beskrivelse	Min.	Maks.
Maks. brugervægt	Ikke relevant	110 kg
Samlet længde med benstøtte (uden hjul)	400 mm	625 mm
Samlet bredde (sædebredde)	250 mm	460 mm
Sammenklappet højde (kun for stole med sammenklappeligt ryglæn)	250 mm	450 mm
Samlet vægt (inkl. hjul)	8 kg	15 kg*
Den tungeste dels vægt (transportvægt)	6 kg	12 kg*
Statisk stabilitet, ned ad bakke	Ikke relevant	5° hældning
Statisk stabilitet, op ad bakke	Ikke relevant	5° hældning
Statisk stabilitet, sidelæns kørsel	Ikke relevant	5° hældning
Sædets vinkel	0°	45° hældning
Effektiv sædedybde	250 mm	460 mm
Sædets overfladehøjde ved forreste kant	480 mm	550 mm
Ryglænsvinkel	-7° hældning	7° hældning
Ryglæns højde	150 mm	400 mm
Afstand mellem fodstøtte og sæde	200 mm	520 mm
Vinkel mellem ben og sædeoverflade	70° vinkel	90° vinkel
Afstand mellem armlæn og sæde	150 mm	300 mm
Forreste placering af armlænsholder	Ikke relevant	Ikke relevant
Drivringsdiameter	24 tommer	26 tommer
Akslens vandrette placering	25 mm	125 mm
Minimum venderadius	270 mm	Ikke relevant

\* Vægt ekskl. tredjepartsdele

Målene er underlagt produktionstolerancer.

ENHED	TILSPÆNDINGSMOMENTER
Ryglænets drejehjul	10 Nm
Hjullås	10 Nm
Camberstang	10 Nm
Fodstøttens justeringshøjde	10 Nm
Alle andre dele	10 Nm

## BEMÆRK:

RGK Wheelchairs Ltd er skræddersyet og fremstilles individuelt efter mål til dig, og derfor kan din kørestol falde under eller over de nævnte størrelser.

### Genbrug/bortskaffelse

Hvis kørestolen skal anvendes af en ny bruger, bør den klargøres grundigt. Alle overflader, der kan komme i kontakt med brugeren, skal aftørres og behandles med en desinficerende spray.

I det følgende afsnit er der en beskrivelse af de materialer, der anvendes på vores kørestole.

**Aluminium:** Stel, hjulgafler, hjul, sidestykker, armlæn, fodstøtte, drivringe, anti-tipsikringer, stel, fodpladebelægning

**Stål:** Stel, fastgørelsespunkter, quick release-akseltappe, fodstøtte, anti-tipsikringer, stelhjul, beslag, hjullåse, fodpladebelægning

**Titan:** Stel, hjulgafler, quick release-aksel, beslag, sidestykker, anti-tipsikringer, stel, fodstøtte

**Plast:** Håndtag, rørpropper, svinghjul, fodpladebelægning, armlænsbolstring

**Emballage:** Plastikposer fremstillet af polyethylen, pap

**Polstring:** Vævet polyester, bomuld, læder



Bortskaffelse eller genbrug bør foretages af et renovationsfirma eller på en offentlig genbrugsstation. Du kan også aflevere kørestolen til din forhandler til bortskaffelse (det kan koste et gebyr).

## BEMÆRK:

Hygiejneprocesser ved genanvendelse:

Hvis kørestolen skal anvendes af en ny bruger, bør den klargøres grundigt. Alle overflader, der kan komme i kontakt med brugeren, skal behandles med desinfektionsmiddel i sprayform.

Der skal til dette formål anvendes et, i dit land, anbefalet desinfektionsmiddel, som bruges til hurtig, alkoholbaseret desinfektion af medicinske hjælpemidler og medicinsk udstyr, når der kræves et hurtigtvirkende desinfektionsmiddel. Vær opmærksom på producentens vejledning til desinfektionsmidlet under anvendelsen.

Det kan ikke garanteres, at sømme kan desinficeres fuldstændigt. For at undgå mikrobakteriel kontaminering anbefales det derfor, at sædet og rygpulstringen kasseres i henhold til lokale retningslinjer om beskyttelse mod infektion.


# Identifikation/serienummer.

Serienummeret på din specialfremstillede kørestol er placeret på enten tværstiveren under sædet (J Produktbeskrivelse) eller camberstangen (H Produktbeskrivelse) eller på indersiden af ryglænets polstring (A).

Ved bestilling af reservedele bedes du venligst give os følgende oplysninger.

Serienummer:
Navn:
Forhandler:

Fig. 25.



## Information om RGK-kørestolens label

- A** - Medicinsk udstyr
- B** - CE-mærkat
- C** - Model
- D** - Serienummer
- E** - Fremstillingsdato
- F** - UDI-stregkode
- G** - Producentens adresse
- H** - UDI menneskeligt læsbar version
- I** - Maksimal brugervægt
- J** - Anvendelsesformål
- K** - Importørens adresse
- L** - UKCA-mærke
- M** - Ansvarlig person i Storbritannien/Schweizisk repræsentant

Identifikationsmærkater  
(Placeret på camberakslen eller under afstiveren under sædet)

# Producentens garanti

## **DENNE GARANTI INDSKRÆNKER IKKE DINE RETTIGHEDER I HENHOLD TIL KØBELOVEN.**

RGK Wheelchairs\* yder en garanti som anført i garantibetingelserne for kørestole til sine kunder, der dækker det følgende.

### **Garantibetingelser**

Hvis en del eller dele kørestolen har brug for reparation eller udskiftning på grund af en produktions- og/eller materialefejl inden for 12 måneder, eller for ramme og tværbeslag inden for 5 år fra levering til kunden, bliver den påvirkede del repareret eller udskiftet gratis.

1. For at gøre garantien gældende skal du kontakte den lokale forhandler, hvor produktet blev købt, med de nøjagtige detaljer om problemets art. Såfremt du anvender kørestolen uden for din lokale forhandlers område, skal reparationer og udskiftninger udføres af en anden part anvist af producenten. Kørestolen skal repareres af en autoriseret servicemedarbejder (forhandler), som er udpeget af RGK Wheelchairs.
2. For dele, som er blevet repareret eller udskiftet inden for garantien, giver vi en garanti i overensstemmelse med disse garantivilkår for kørestolens resterende garantiperiode i henhold til punkt 1).
3. For originale reservedele, der er blevet monteret på kundens regning, er disse dækket af en garanti på 12 måneder, (efter monteringen), i overensstemmelse med disse garantibetingelser.
4. Forbrugsdele såsom puder, dæk, slanger og lignende dele er ikke dækket af garantien, undtagen i tilfælde af for tidlig slitage af den del, er et direkte resultat af en fabriktionsfejl.
5. Erstatningskrav fra denne garanti kan ikke forekomme, for reparationer eller udskiftninger på kørestolen nødvendiggjort som følge af, at:
  - Kørestolen eller delen ikke er vedligeholdt i henhold til producentens anbefalinger som angivet i brugervejledningen og/eller den tekniske vejledning.
  - Der er anvendt andet tilbehør end det, der er angivet som originalt tilbehør fra producentens side.
  - Kørestolen eller reservedelen er beskadiget som følge af misligholdelse, uheld eller uhensigtsmæssig brug.
  - Ændringer/modificeringer er blevet foretaget på kørestolen eller reservedele, der afviger fra producentens specifikationer.
  - Hvis der er foretaget reparationer, inden kundeservice er blevet informeret om problemerne.
6. Denne garanti er omfattet af loven i det land, hvor produktet blev købt fra RGK Wheelchairs.

\* Betyder den autoriserede RGK-forhandler, hvorfra produktet blev købt.

Sunrise Medical S.r.l.  
Via Riva, 20 – Montale  
29122 Piacenza  
Italia  
Tel.: +39 0523 573111  
Fax: +39 0523 570060  
www.SunriseMedical.it

Sunrise Medical AG  
Erlenauweg 17  
CH-3110 Münsingen  
Schweiz/Suisse/Svizzera  
Fon +41 (0)31 958 3838  
Fax +41 (0)31 958 3848  
www.SunriseMedical.ch

Sunrise Medical AS  
Delitoppen 3  
1540 Vestby  
Norge  
Telefon: +47 66 96 38 00  
post@sunrisemedical.no  
www.SunriseMedical.no

Sunrise Medical AB  
Neogatan 5  
431 53 Mölndal  
Sweden  
Tel.: +46 (0)31 748 37 00  
post@sunrisemedical.se  
www.SunriseMedical.se

MEDICCO s.r.o.  
H – Park, Heršpická 1013/11d,  
625 00 Brno  
Czech Republic  
Tel.: (+420) 547 250 955  
Fax: (+420) 547 250 956  
www.medicco.cz  
info@medicco.cz  
Bezplatná linka 800 900 809

Sunrise Medical Aps  
Mårkærvej 5-9  
2630 Taastrup  
Denmark  
+45 70 22 43 49  
info@sunrisemedical.dk  
Sunrisemedical.dk

Sunrise Medical Pty. Ltd.  
11 Daniel Street, Wetherill Park,  
NSW 2164,  
Australia  
Phone: 9678 6600,  
Orders Fax: 9678 6655, Admin Fax:  
9831 2244. Australia  
www.sunrisemedical.com.au

Sunrise Medical (US) LLC  
North American Headquarters  
12002 Volunteer Blvd.  
Mount Juliet, TN 37122  
Tel: 1-800-333-4000  
Fax: 1-800-300-7502  
www.SunriseMedical.com



Sunrise Medical GmbH  
Kahlbachring 2-4  
69254 Malsch/Heidelberg  
Deutschland  
Tel.: +49 (0) 7253/980-0  
Fax: +49 (0) 7253/980-222  
www.SunriseMedical.de

Sunrise Medical  
Thorns Road  
Brierley Hill  
West Midlands  
DY5 2LD  
England  
Phone: 0845 605 66 88  
Fax: 0845 605 66 89  
www.SunriseMedical.co.uk

Sunrise Medical S.L.  
Polígono Bakiola, 41  
48498 Arrankudiaga – Vizcaya  
España  
Tel.: +34 (0) 902142434  
Fax: +34 (0) 946481575  
www.SunriseMedical.es

Sunrise Medical Poland  
Sp. z o.o.  
ul. Elektronowa 6,  
94-103 Łódź  
Polska  
Telefon: + 48 42 275 83 38  
Fax: + 48 42 209 35 23  
E-mail: pl@sunrisemedical.de  
www.Sunrise-Medical.pl

Sunrise Medical HCM B.V.  
Vossenbeemd 104  
5705 CL Helmond  
The Netherlands  
T: +31 (0)492 593 888  
E: customerservice@sunrisemedical.nl  
www.SunriseMedical.nl  
www.SunriseMedical.eu  
(International)

Sunrise Medical SAS  
ZAC de la Vrillonnerie  
17 Rue Michaël Faraday  
37170 Chambray-Lès-Tours  
Tel : +33 (0) 2 47 55 44 00  
Email: info@sunrisemedical.fr  
www.sunrisemedical.fr

Sunrise Medical Canada Inc.  
1000 Creditstone Rd., Unit #2  
Concord, ON, L4K 4P8  
Canada  
Phone: 1-800-263-3390  
Fax: 1-800-561-5834  
www.SunriseMedical.ca



RGK Wheelchairs LTD.  
Unit 8 A/B/C Ring Road Zone  
2, Burntwood Industrial Estate,  
Burntwood, Staffordshire, WS7 3JQ,  
UK

Ring til: +44(0)1543 670 077  
E-mail: info@rgkwheelchairs.com

